


Measurement Details	Measurement Details
Nazwa próbki	Źródło wyniku Uśredniony
	Typ aparatu Mastersizer3000

Analysis	Result
Współczynnik załamania światła 2,918	Rozpiętość 5
Współczynnik absorpcji 0,100	Jednorodność 1
Nazwa dyspersanta Wody	Dv (10)
Wsp. zał. światła dyspersanta 1,330	Dv (50)
Model rozpraszania Mie	Dv (90)
Model analizy Ogólnego zastosowania	Objętość poniżej (10) μm
Residuum ważone 0,2 %	Objętość poniżej (2,5) μm
Obskuracja 5 %	Objętość poniżej (1) μm

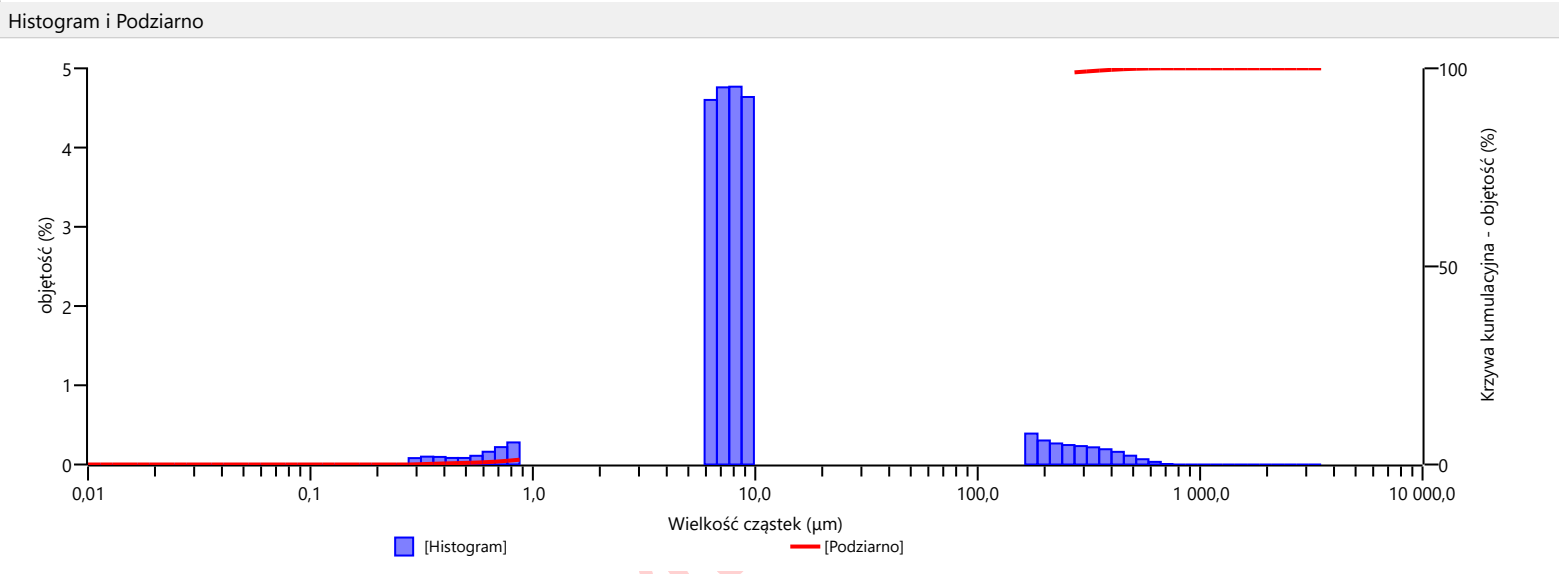

Wynik									
Wielkość cząstek (μm)	% objętość w	Wielkość cząstek (μm)	% objętość w	Wielkość cząstek (μm)	% objętość w	Wielkość cząstek (μm)	% objętość w	Wielkość cząstek (μm)	% objętość w
0,0100	0,00	0,146	0,00					454	0,11
0,0114								516	0,07